



## Come effettuare il test

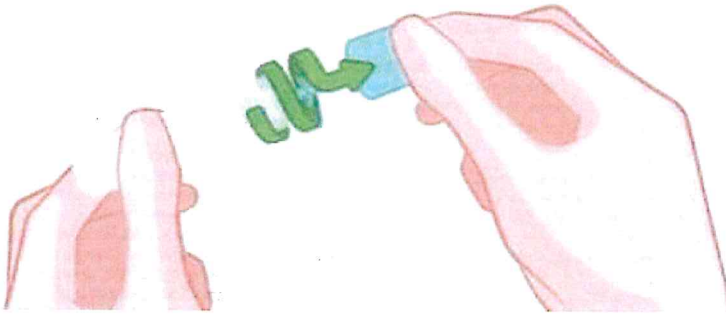


Aprire il dispositivo

Tenere il dispositivo come illustrato nella figura sottostante facendo in modo che la spugna contenuta all'interno del dispositivo non tocchi superfici o altre parti del corpo diverse dalla bocca

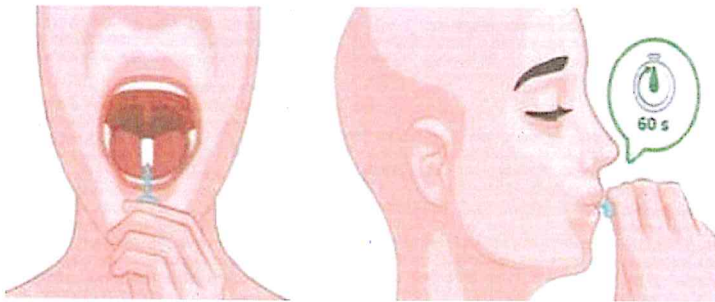

Muovere delicatamente il dispositivo all'interno della bocca per 60 secondi (parte superiore della lingua e fra denti e gengiva).

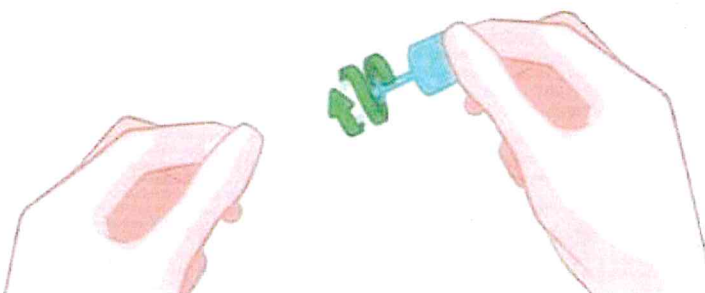

Chiudere il dispositivo facendo in modo che la spugna contenuta all'interno del dispositivo non tocchi altre superfici.